


Data e ora della misurazione 22/01/2025 10:37:00

REM\LINEA 2\VENTILATORE ARIAPRIMARIA S25 C0-019\X\VENTILATORE\S2H\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC

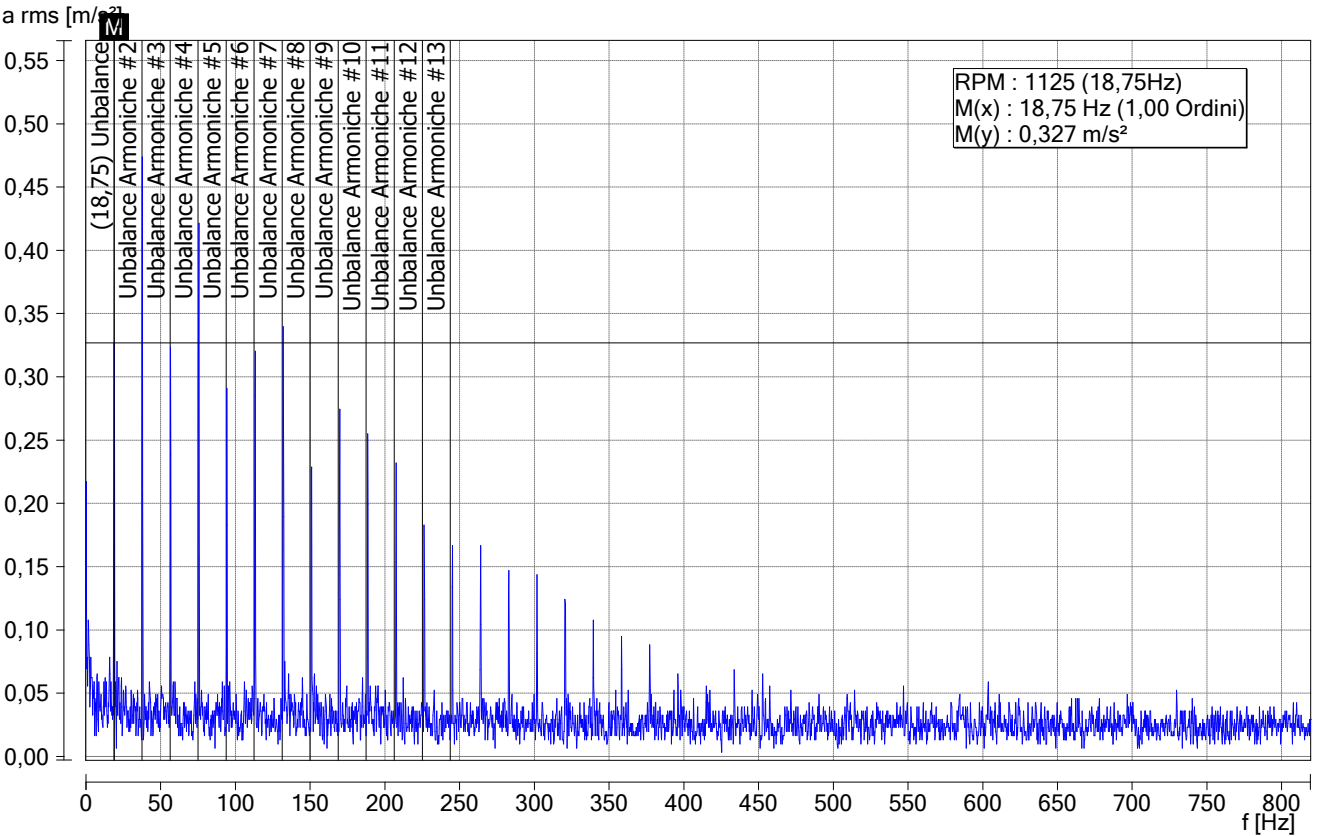

Cursore X [Hz] = 18,75 (18,75) Unbalance
Principale Y [m/s²] = 0,327
Cursore delta X [Hz] = Non Attivo
Y [m/s²] = Non Attivo
RPM = 1125
RMS Y [m/s²] = 1,78

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	37,75	0,474
2	75,50	0,422
3	132,00	0,340
4	18,75	0,327
5	56,50	0,324
6	113,25	0,320
7	94,25	0,291
8	169,75	0,274
9	188,50	0,255
10	207,50	0,232