
ANALISI TERMOGRAFICA

MOTORE N.838318 GF-2-B


FCA ITALY Pratola Serra (AV)

Indice

IR_00480.IS2	4
IR_00481.IS2	5
IR_00482.IS2	6
IR_00483.IS2	7
IR_00484.IS2	8
IR_00485.IS2	9
IR_00486.IS2	10
IR_00487.IS2	11
IR_00488.IS2	12
IR_00489.IS2	13
IR_00490.IS2	14
IR_00491.IS2	15
IR_00492.IS2	16
IR_00493.IS2	17
IR_00494.IS2	18
IR_00495.IS2	19
IR_00496.IS2	20
IR_00497.IS2	21
IR_00498.IS2	22

Riepilogo ispezione

Nome file	IR_00480.IS2	Data e ora ispezione	03/07/2019 16:11:59
Gravità			
Nome file	IR_00481.IS2	Data e ora ispezione	03/07/2019 16:17:21
Gravità			
Nome file	IR_00482.IS2	Data e ora ispezione	03/07/2019 16:17:37
Gravità			
Nome file	IR_00483.IS2	Data e ora ispezione	03/07/2019 16:17:48
Gravità			
Nome file	IR_00484.IS2	Data e ora ispezione	03/07/2019 16:18:21
Gravità			
Nome file	IR_00485.IS2	Data e ora ispezione	03/07/2019 16:18:28
Gravità			
Nome file	IR_00486.IS2	Data e ora ispezione	03/07/2019 16:18:42
Gravità			
Nome file	IR_00487.IS2	Data e ora ispezione	03/07/2019 18:51:41
Gravità			
Nome file	IR_00488.IS2	Data e ora ispezione	03/07/2019 18:51:54
Gravità			
Nome file	IR_00489.IS2	Data e ora ispezione	03/07/2019 18:52:27
Gravità			
Nome file	IR_00490.IS2	Data e ora ispezione	03/07/2019 18:52:39
Gravità			
Nome file	IR_00491.IS2	Data e ora ispezione	03/07/2019 18:52:55
Gravità			
Nome file	IR_00492.IS2	Data e ora ispezione	03/07/2019 18:53:21
Gravità			
Nome file	IR_00493.IS2	Data e ora ispezione	03/07/2019 18:53:38
Gravità			
Nome file	IR_00494.IS2	Data e ora ispezione	03/07/2019 18:53:50
Gravità			
Nome file	IR_00495.IS2	Data e ora ispezione	03/07/2019 18:54:15
Gravità			
Nome file	IR_00496.IS2	Data e ora ispezione	03/07/2019 18:54:44
Gravità			
Nome file	IR_00497.IS2	Data e ora ispezione	03/07/2019 18:57:28
Gravità			
Nome file	IR_00498.IS2	Data e ora ispezione	03/07/2019 18:57:54
Gravità			

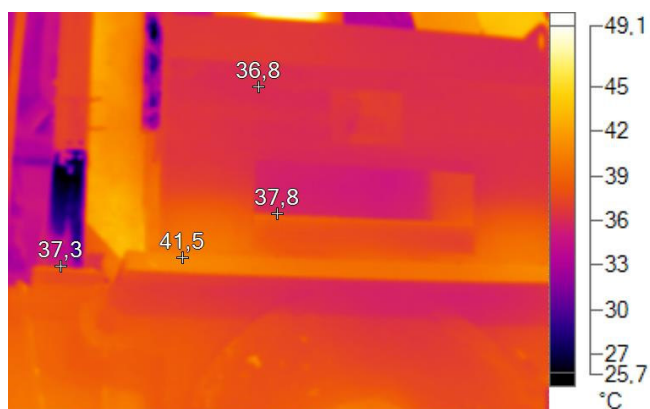

IR_00480.IS2
03/07/2019 16:11:59


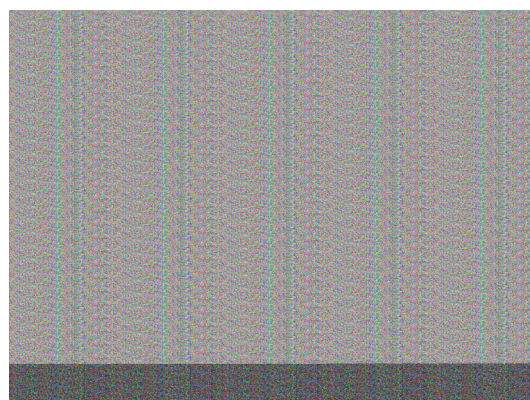


Immagine a luce visibile

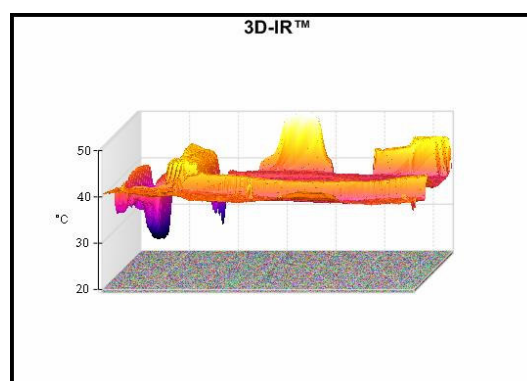

Diagramma

Marker immagine principale

Nome	Temperatura	Emissività	Sfondo
Punto centrale	37,8°C	0,95	22,0°C
P0	36,8°C	0,95	22,0°C
P1	37,3°C	0,95	22,0°C
P2	41,5°C	0,95	22,0°C

Informazioni immagine

Nome file	IR_00480.IS2
Emissività	0,95
Modello termocamera	Ti200
Dimensioni sensore IR	200 x 150
Numero di serie termocamera	Ti200-16030252
Produttore termocamera	Fluke Thermography
Ora immagine	03/07/2019 16:11:59
Distanza dall'oggetto	3,24m



IR_00481.IS2
03/07/2019 16:17:21


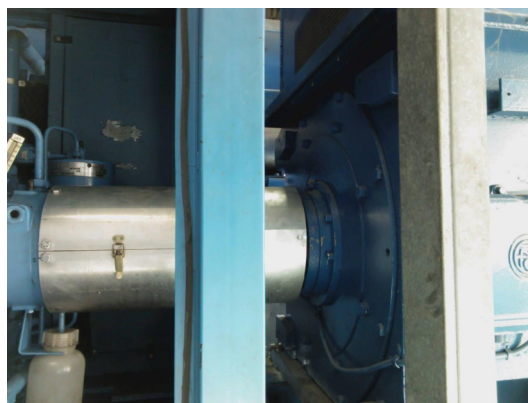


Immagine a luce visibile

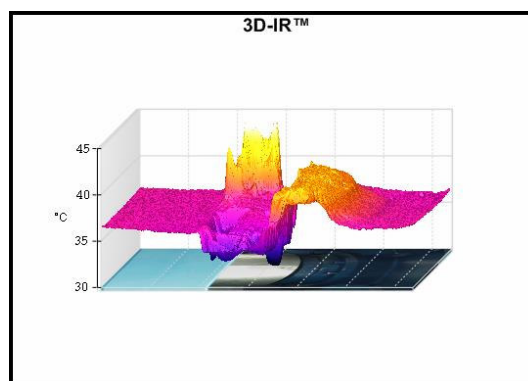

Diagramma

Marker immagine principale

Nome	Temperatura	Emissività	Sfondo
Punto centrale	33,3°C	0,95	22,0°C
P0	38,2°C	0,95	22,0°C
P1	36,2°C	0,95	22,0°C
P2	33,8°C	0,95	22,0°C

Informazioni immagine


Nome file	IR_00481.IS2
Emissività	0,95
Modello termocamera	Ti200
Dimensioni sensore IR	200 x 150
Numero di serie termocamera	Ti200-16030252
Produttore termocamera	Fluke Thermography
Ora immagine	03/07/2019 16:17:21
Distanza dall'oggetto	0,93m



IR_00482.IS2
03/07/2019 16:17:37



Immagine a luce visibile

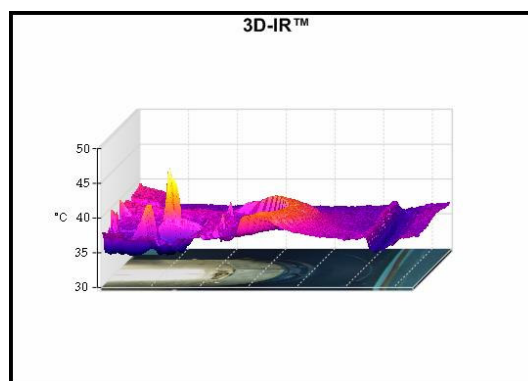


Diagramma

Marker immagine principale

Nome	Temperatura	Emissività	Sfondo
Punto centrale	36,7°C	0,95	22,0°C
P0	36,8°C	0,95	22,0°C
P1	37,2°C	0,95	22,0°C
P2	37,4°C	0,95	22,0°C

Informazioni immagine


Nome file	IR_00482.IS2
Emissività	0,95
Modello termocamera	Ti200
Dimensioni sensore IR	200 x 150
Numero di serie termocamera	Ti200-16030252
Produttore termocamera	Fluke Thermography
Ora immagine	03/07/2019 16:17:37
Distanza dall'oggetto	0,93m

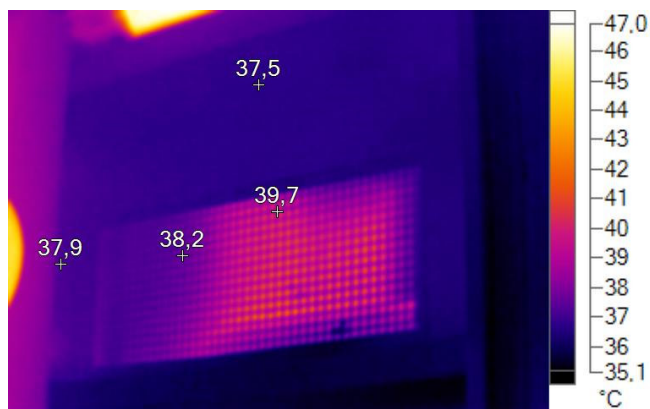

IR_00483.IS2
03/07/2019 16:17:48



Immagine a luce visibile

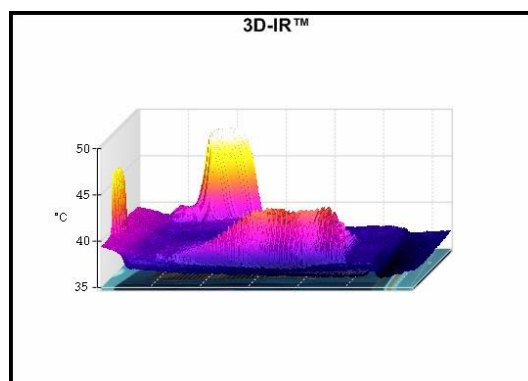


Diagramma

Marker immagine principale

Nome	Temperatura	Emissività	Sfondo
Punto centrale	39,7°C	0,95	22,0°C
P0	37,5°C	0,95	22,0°C
P1	37,9°C	0,95	22,0°C
P2	38,2°C	0,95	22,0°C

Informazioni immagine


Nome file	IR_00483.IS2
Emissività	0,95
Modello termocamera	Ti200
Dimensioni sensore IR	200 x 150
Numero di serie termocamera	Ti200-16030252
Produttore termocamera	Fluke Thermography
Ora immagine	03/07/2019 16:17:48
Distanza dall'oggetto	0,93m

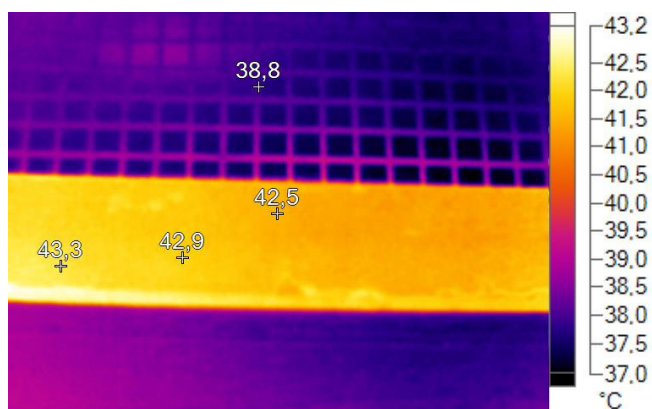

IR_00484.IS2
03/07/2019 16:18:21



Immagine a luce visibile

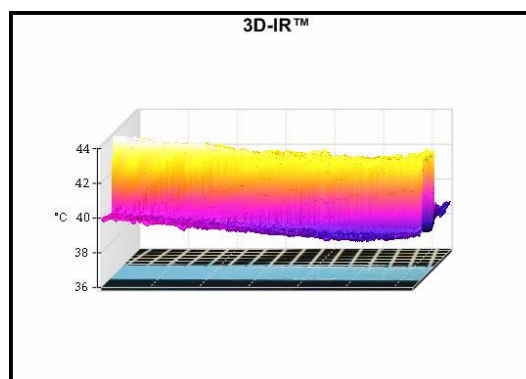


Diagramma

Marker immagine principale

Nome	Temperatura	Emissività	Sfondo
Punto centrale	42,5°C	0,95	22,0°C
P0	38,8°C	0,95	22,0°C
P1	43,3°C	0,95	22,0°C
P2	42,9°C	0,95	22,0°C

Informazioni immagine

Nome file	IR_00484.IS2
Emissività	0,95
Modello termocamera	Ti200
Dimensioni sensore IR	200 x 150
Numero di serie termocamera	Ti200-16030252
Produttore termocamera	Fluke Thermography
Ora immagine	03/07/2019 16:18:21
Distanza dall'oggetto	0,46m

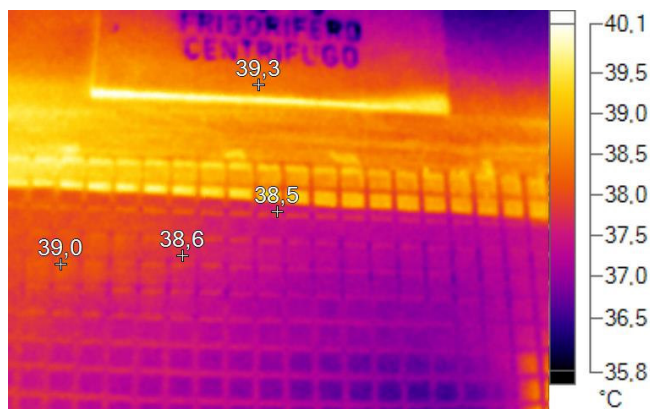

IR_00485.IS2
03/07/2019 16:18:28


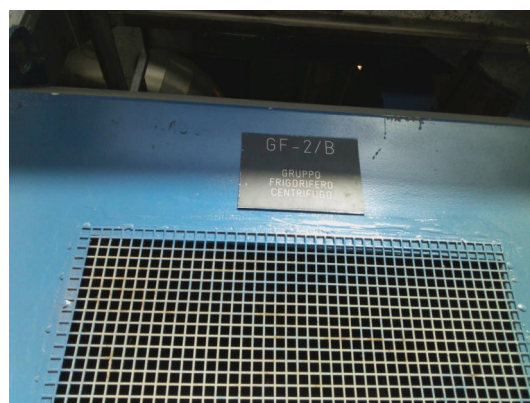


Immagine a luce visibile

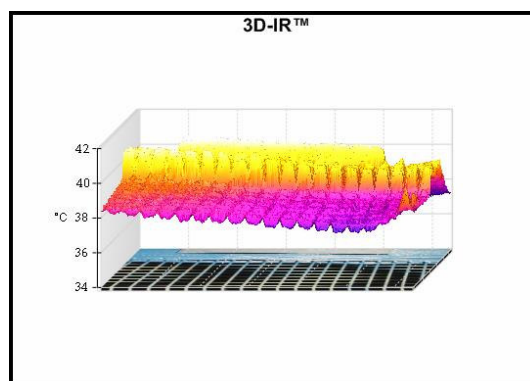


Diagramma

Marker immagine principale

Nome	Temperatura	Emissività	Sfondo
Punto centrale	38,5°C	0,95	22,0°C
P0	39,3°C	0,95	22,0°C
P1	39,0°C	0,95	22,0°C
P2	38,6°C	0,95	22,0°C

Informazioni immagine

Nome file	IR_00485.IS2
Emissività	0,95
Modello termocamera	Ti200
Dimensioni sensore IR	200 x 150
Numero di serie termocamera	Ti200-16030252
Produttore termocamera	Fluke Thermography
Ora immagine	03/07/2019 16:18:28
Distanza dall'oggetto	0,46m

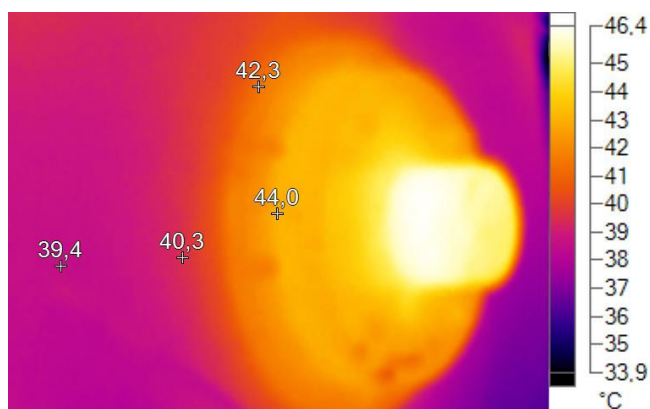

IR_00486.IS2
03/07/2019 16:18:42


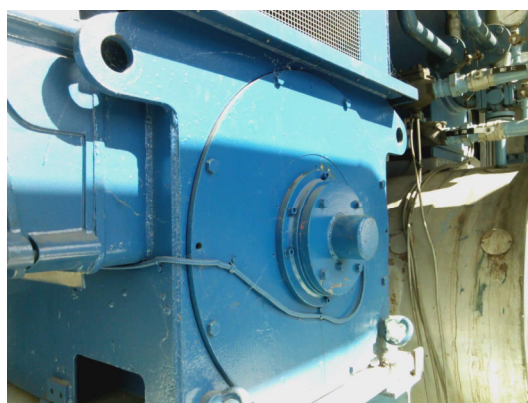


Immagine a luce visibile

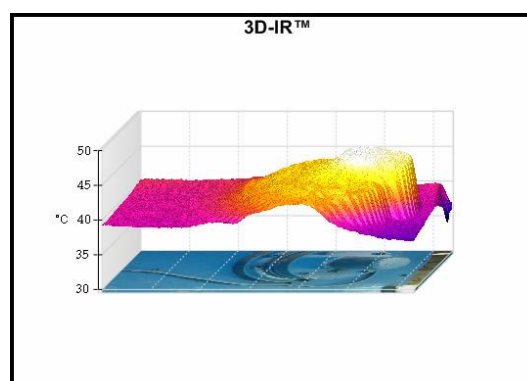


Diagramma

Marker immagine principale

Nome	Temperatura	Emissività	Sfondo
Punto centrale	44,0°C	0,95	22,0°C
P0	42,3°C	0,95	22,0°C
P1	39,4°C	0,95	22,0°C
P2	40,3°C	0,95	22,0°C

Informazioni immagine


Nome file	IR_00486.IS2
Emissività	0,95
Modello termocamera	Ti200
Dimensioni sensore IR	200 x 150
Numero di serie termocamera	Ti200-16030252
Produttore termocamera	Fluke Thermography
Ora immagine	03/07/2019 16:18:42
Distanza dall'oggetto	0,46m

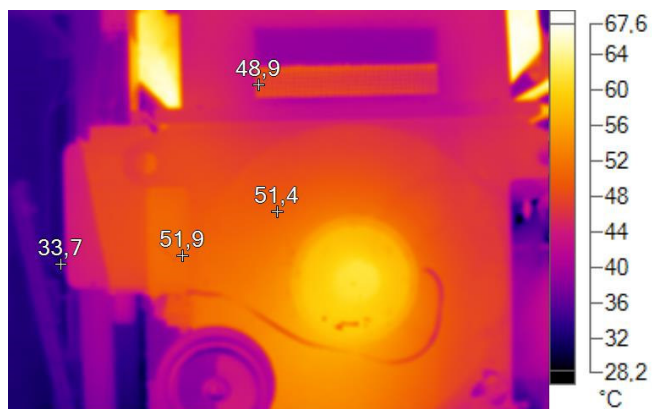

IR_00487.IS2
03/07/2019 18:51:41



Immagine a luce visibile

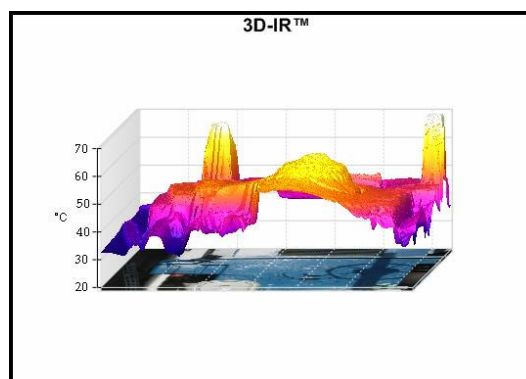

Diagramma

Marker immagine principale

Nome	Temperatura	Emissività	Sfondo
Punto centrale	51,4°C	0,95	22,0°C
P0	48,9°C	0,95	22,0°C
P1	33,7°C	0,95	22,0°C
P2	51,9°C	0,95	22,0°C

Informazioni immagine


Nome file	IR_00487.IS2
Emissività	0,95
Modello termocamera	Ti200
Dimensioni sensore IR	200 x 150
Numero di serie termocamera	Ti200-16030252
Produttore termocamera	Fluke Thermography
Ora immagine	03/07/2019 18:51:41
Distanza dall'oggetto	2,76m



IR_00488.IS2
03/07/2019 18:51:54



Immagine a luce visibile

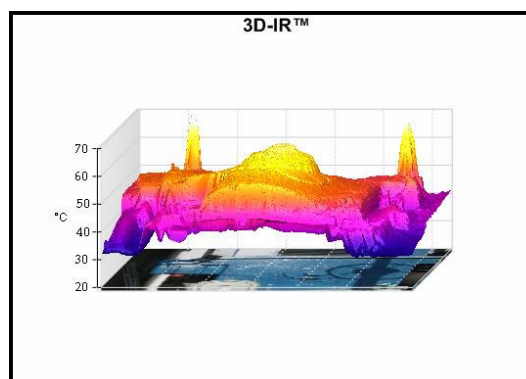


Diagramma

Marker immagine principale

Nome	Temperatura	Emissività	Sfondo
Punto centrale	62,8°C	0,95	22,0°C
P0	50,3°C	0,95	22,0°C
P1	34,6°C	0,95	22,0°C
P2	41,8°C	0,95	22,0°C

Informazioni immagine


Nome file	IR_00488.IS2
Emissività	0,95
Modello termocamera	Ti200
Dimensioni sensore IR	200 x 150
Numero di serie termocamera	Ti200-16030252
Produttore termocamera	Fluke Thermography
Ora immagine	03/07/2019 18:51:54
Distanza dall'oggetto	2,76m

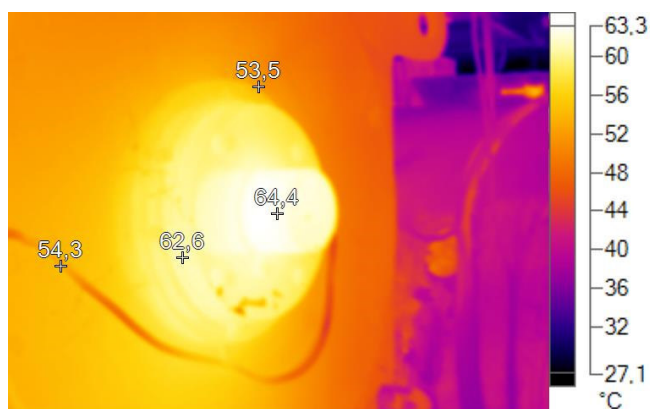

IR_00489.IS2
03/07/2019 18:52:27



Immagine a luce visibile

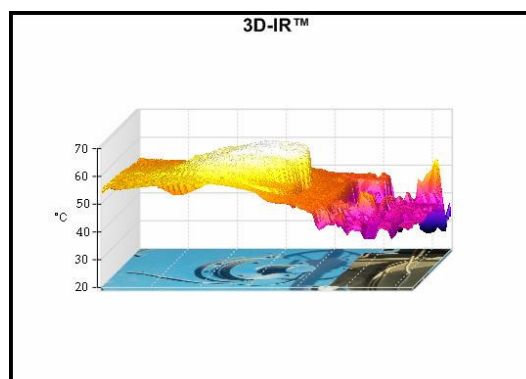


Diagramma

Marker immagine principale

Nome	Temperatura	Emissività	Sfondo
Punto centrale	64,4°C	0,95	22,0°C
P0	53,5°C	0,95	22,0°C
P1	54,3°C	0,95	22,0°C
P2	62,6°C	0,95	22,0°C

Informazioni immagine


Nome file	IR_00489.IS2
Emissività	0,95
Modello termocamera	Ti200
Dimensioni sensore IR	200 x 150
Numero di serie termocamera	Ti200-16030252
Produttore termocamera	Fluke Thermography
Ora immagine	03/07/2019 18:52:27
Distanza dall'oggetto	2,76m

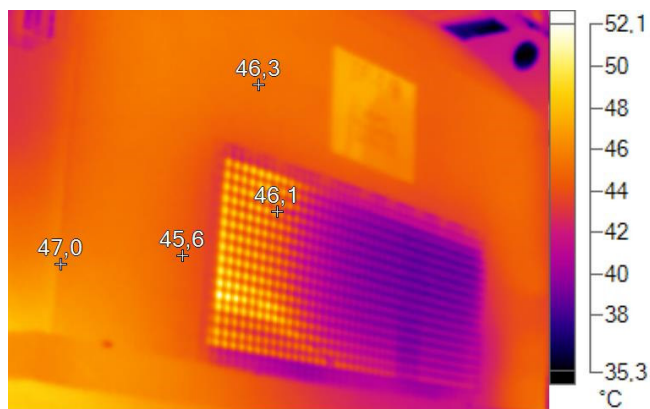

IR_00490.IS2
03/07/2019 18:52:39



Immagine a luce visibile

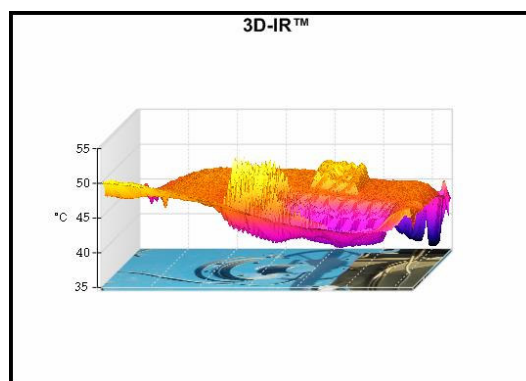


Diagramma

Marker immagine principale

Nome	Temperatura	Emissività	Sfondo
Punto centrale	46,1°C	0,95	22,0°C
P0	46,3°C	0,95	22,0°C
P1	47,0°C	0,95	22,0°C
P2	45,6°C	0,95	22,0°C

Informazioni immagine


Nome file	IR_00490.IS2
Emissività	0,95
Modello termocamera	Ti200
Dimensioni sensore IR	200 x 150
Numero di serie termocamera	Ti200-16030252
Produttore termocamera	Fluke Thermography
Ora immagine	03/07/2019 18:52:39
Distanza dall'oggetto	2,76m

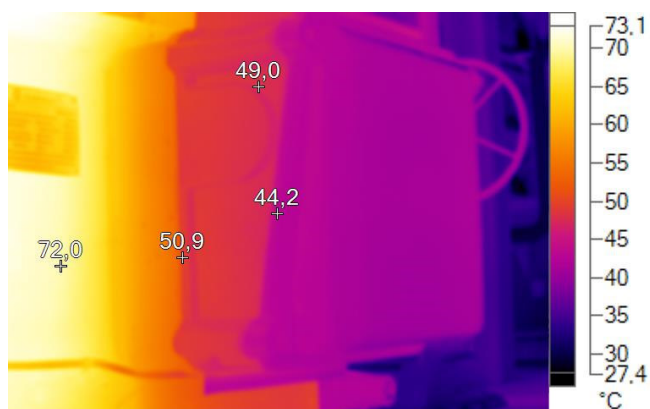

IR_00491.IS2
03/07/2019 18:52:55



Immagine a luce visibile

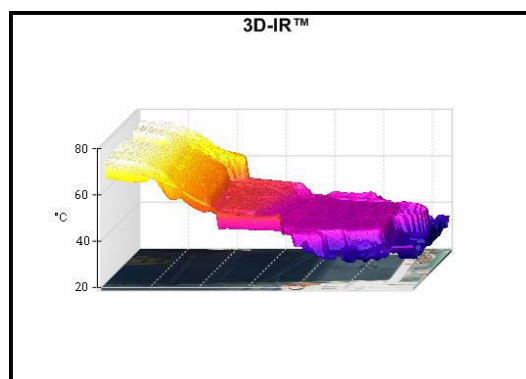


Diagramma

Marker immagine principale

Nome	Temperatura	Emissività	Sfondo
Punto centrale	44,2°C	0,95	22,0°C
P0	49,0°C	0,95	22,0°C
P1	72,0°C	0,95	22,0°C
P2	50,9°C	0,95	22,0°C

Informazioni immagine


Nome file	IR_00491.IS2
Emissività	0,95
Modello termocamera	Ti200
Dimensioni sensore IR	200 x 150
Numero di serie termocamera	Ti200-16030252
Produttore termocamera	Fluke Thermography
Ora immagine	03/07/2019 18:52:55
Distanza dall'oggetto	2,76m

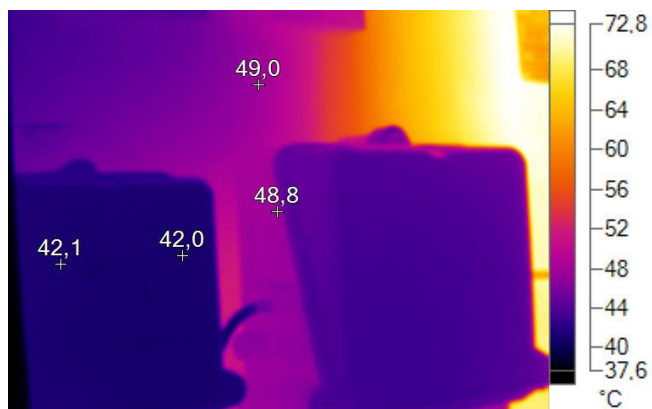

IR_00492.IS2
03/07/2019 18:53:21



Immagine a luce visibile

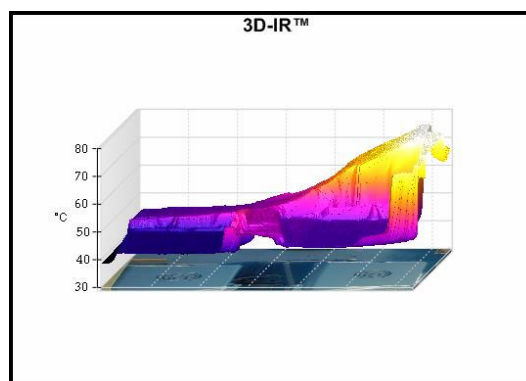


Diagramma

Marker immagine principale

Nome	Temperatura	Emissività	Sfondo
Punto centrale	48,8°C	0,95	22,0°C
P0	49,0°C	0,95	22,0°C
P1	42,1°C	0,95	22,0°C
P2	42,0°C	0,95	22,0°C

Informazioni immagine

Nome file	IR_00492.IS2
Emissività	0,95
Modello termocamera	Ti200
Dimensioni sensore IR	200 x 150
Numero di serie termocamera	Ti200-16030252
Produttore termocamera	Fluke Thermography
Ora immagine	03/07/2019 18:53:21
Distanza dall'oggetto	1,27m

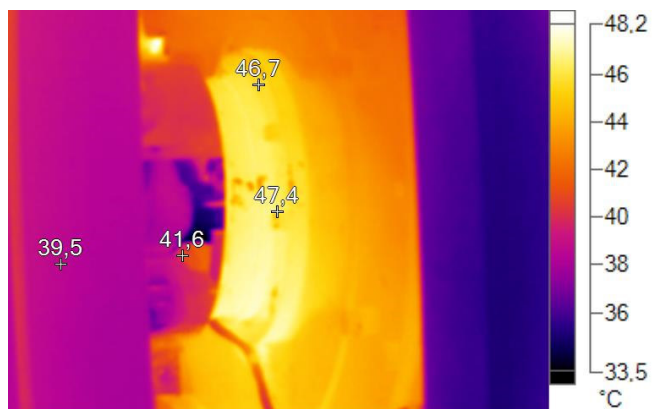

IR_00493.IS2
03/07/2019 18:53:38


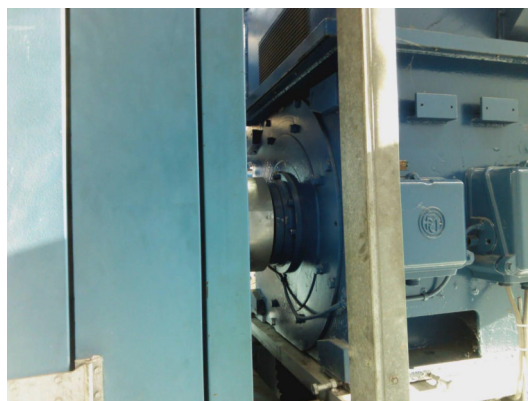


Immagine a luce visibile

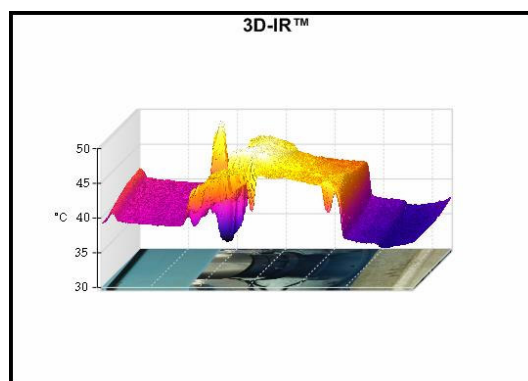


Diagramma

Marker immagine principale

Nome	Temperatura	Emissività	Sfondo
Punto centrale	47,4°C	0,95	22,0°C
P0	46,7°C	0,95	22,0°C
P1	39,5°C	0,95	22,0°C
P2	41,6°C	0,95	22,0°C

Informazioni immagine


Nome file	IR_00493.IS2
Emissività	0,95
Modello termocamera	Ti200
Dimensioni sensore IR	200 x 150
Numero di serie termocamera	Ti200-16030252
Produttore termocamera	Fluke Thermography
Ora immagine	03/07/2019 18:53:38
Distanza dall'oggetto	1,35m

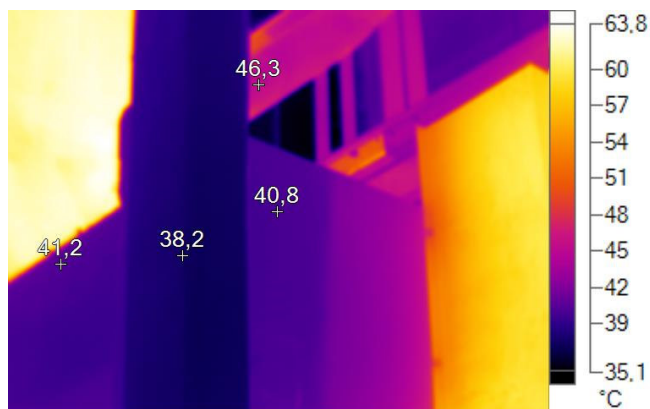

IR_00494.IS2
03/07/2019 18:53:50



Immagine a luce visibile

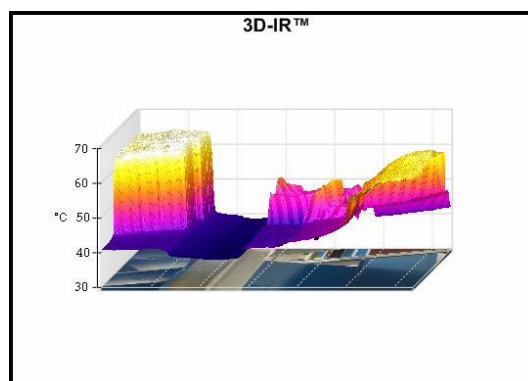


Diagramma

Marker immagine principale

Nome	Temperatura	Emissività	Sfondo
Punto centrale	40,8°C	0,95	22,0°C
P0	46,3°C	0,95	22,0°C
P1	41,2°C	0,95	22,0°C
P2	38,2°C	0,95	22,0°C

Informazioni immagine


Nome file	IR_00494.IS2
Emissività	0,95
Modello termocamera	Ti200
Dimensioni sensore IR	200 x 150
Numero di serie termocamera	Ti200-16030252
Produttore termocamera	Fluke Thermography
Ora immagine	03/07/2019 18:53:50
Distanza dall'oggetto	1,35m

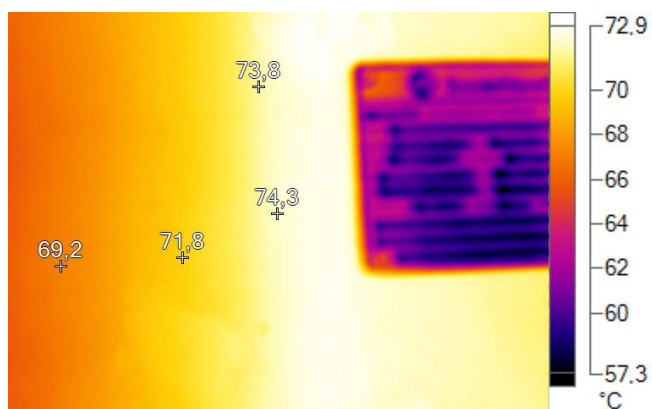

IR_00495.IS2
03/07/2019 18:54:15



Immagine a luce visibile

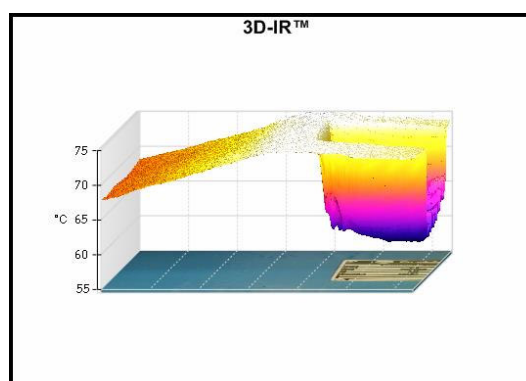


Diagramma

Marker immagine principale

Nome	Temperatura	Emissività	Sfondo
Punto centrale	74,3°C	0,95	22,0°C
P0	73,8°C	0,95	22,0°C
P1	69,2°C	0,95	22,0°C
P2	71,8°C	0,95	22,0°C

Informazioni immagine


Nome file	IR_00495.IS2
Emissività	0,95
Modello termocamera	Ti200
Dimensioni sensore IR	200 x 150
Numero di serie termocamera	Ti200-16030252
Produttore termocamera	Fluke Thermography
Ora immagine	03/07/2019 18:54:15
Distanza dall'oggetto	1,35m

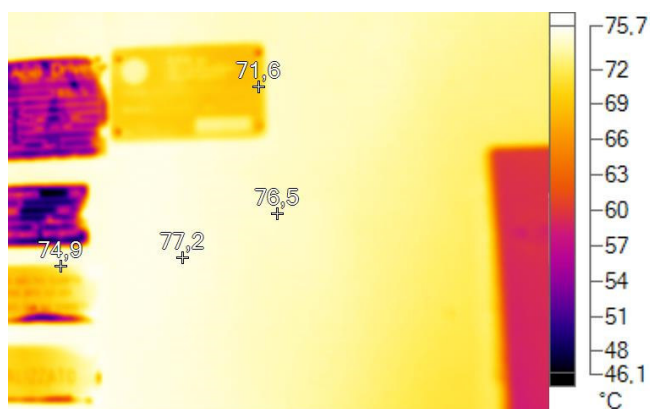

IR_00496.IS2
03/07/2019 18:54:44



Immagine a luce visibile

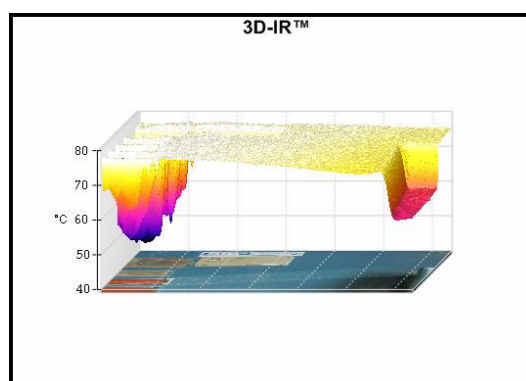


Diagramma

Marker immagine principale

Nome	Temperatura	Emissività	Sfondo
Punto centrale	76,5°C	0,95	22,0°C
P0	71,6°C	0,95	22,0°C
P1	74,9°C	0,95	22,0°C
P2	77,2°C	0,95	22,0°C

Informazioni immagine


Nome file	IR_00496.IS2
Emissività	0,95
Modello termocamera	Ti200
Dimensioni sensore IR	200 x 150
Numero di serie termocamera	Ti200-16030252
Produttore termocamera	Fluke Thermography
Ora immagine	03/07/2019 18:54:44
Distanza dall'oggetto	1,35m

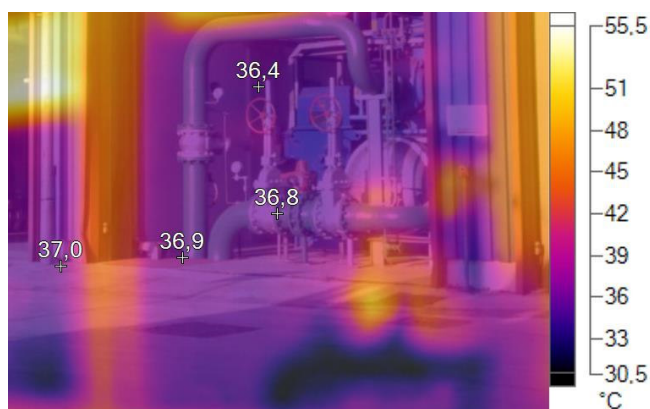

IR_00497.IS2
03/07/2019 18:57:28



Immagine a luce visibile

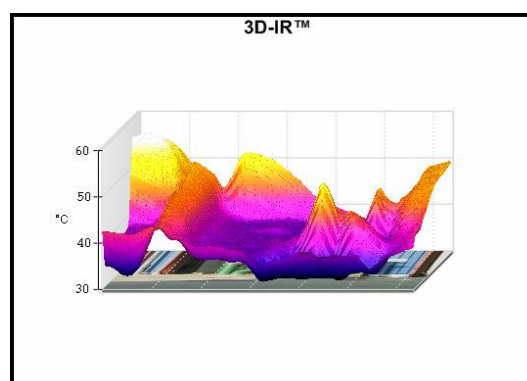


Diagramma

Marker immagine principale

Nome	Temperatura	Emissività	Sfondo
Punto centrale	36,8°C	0,95	22,0°C
P0	36,4°C	0,95	22,0°C
P1	37,0°C	0,95	22,0°C
P2	36,9°C	0,95	22,0°C

Informazioni immagine


Nome file	IR_00497.IS2
Emissività	0,95
Modello termocamera	Ti200
Dimensioni sensore IR	200 x 150
Numero di serie termocamera	Ti200-16030252
Produttore termocamera	Fluke Thermography
Ora immagine	03/07/2019 18:57:28
Distanza dall'oggetto	0,00m

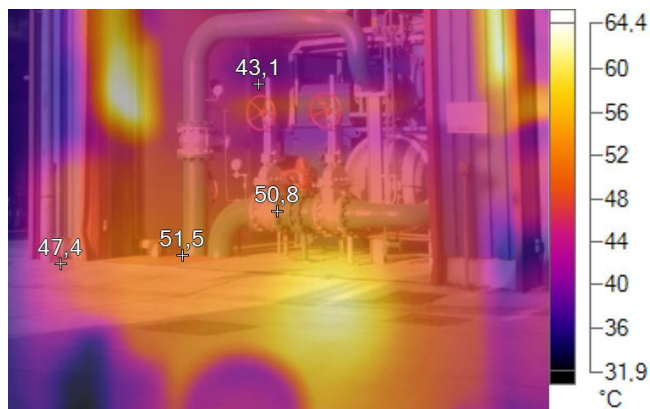

IR_00498.IS2
03/07/2019 18:57:54



Immagine a luce visibile

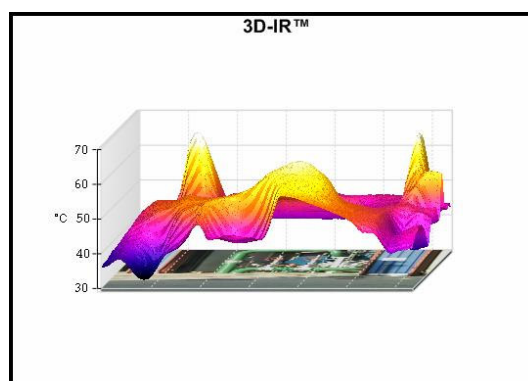

Diagramma

Marker immagine principale

Nome	Temperatura	Emissività	Sfondo
Punto centrale	50,8°C	0,95	22,0°C
P0	43,1°C	0,95	22,0°C
P1	47,4°C	0,95	22,0°C
P2	51,5°C	0,95	22,0°C

Informazioni immagine

Nome file	IR_00498.IS2
Emissività	0,95
Modello termocamera	Ti200
Dimensioni sensore IR	200 x 150
Numero di serie termocamera	Ti200-16030252
Produttore termocamera	Fluke Thermography
Ora immagine	03/07/2019 18:57:54
Distanza dall'oggetto	0,00m