




Data e ora della misurazione10/12/2019 10:07:37

Siniat\In Sito\Aspirazione Filtro Luhr - 30\Ventilatore\V1V\103 Mach. spectr. >600

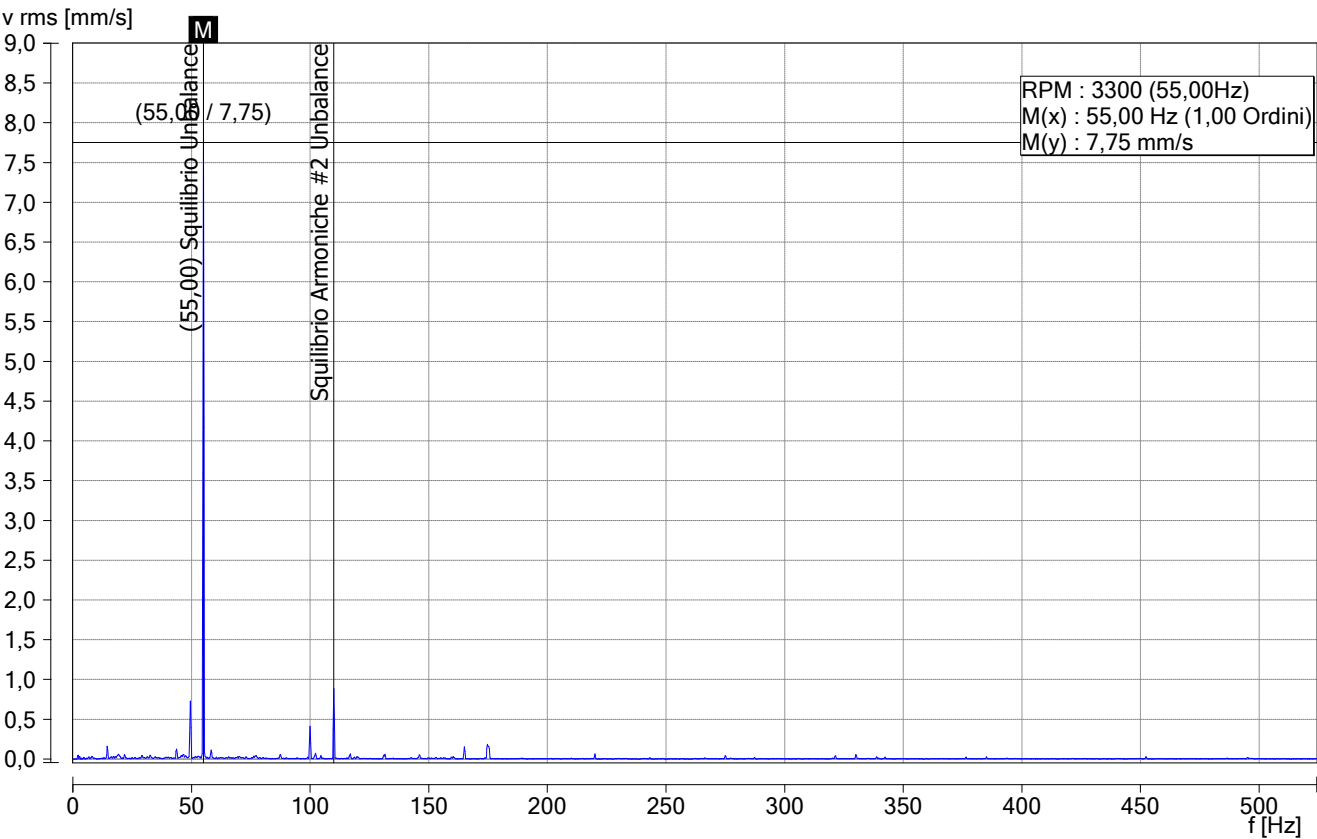

Cursore Principale	X [Hz]	= 55,00	(55,00) Squilibrio Unbalance
	Y [mm/s]	= 7,75	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 3300	
RMS	Y [mm/s]	= 7,86	

Data	Ora	Evento	Commento
09/12/2019	17:07:53	Misura mancante	Misura mancante.
09/12/2019	12:55:43	Misura mancante	Misura mancante.
19/08/2019	16:10:26	Misura mancante	Misura mancante.
19/08/2019	12:42:40	Misura mancante	Misura mancante.



19/06/2019	14:04:41	Misura mancante	Misura mancante.
17/06/2019	17:16:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/06/2019	13:53:20	Misura mancante	Misura mancante.
16/06/2019	13:40:53	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:59:59	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:39:46	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	16:42:36	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	12:50:36	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	13:50:15	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	17:10:57	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	13:46:34	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	14:53:31	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	10:22:05	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	17:09:44	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	14:07:46	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	17:30:48	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	14:02:37	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2018	12:55:27	Misura mancante	Misura mancante.
24/11/2017	12:15:48	Misura mancante	Misura mancante.
23/11/2017	17:15:39	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	55,00	7,75
2	110,00	0,88
3	49,50	0,73
4	100,00	0,41
5	174,75	0,18
6	14,50	0,16
7	175,25	0,16
8	165,00	0,15
9	43,75	0,13
10	58,25	0,11